取扱説明書

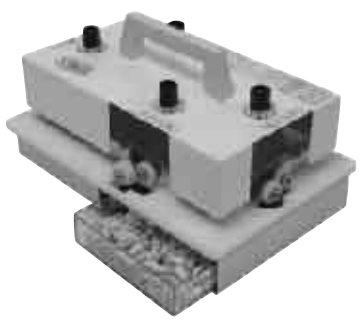

らく錠くんタイプ４Ｒ
ＨＴ－２００３

らく錠くんタイプ２
ＨＴ－３００３

《各部の名称》

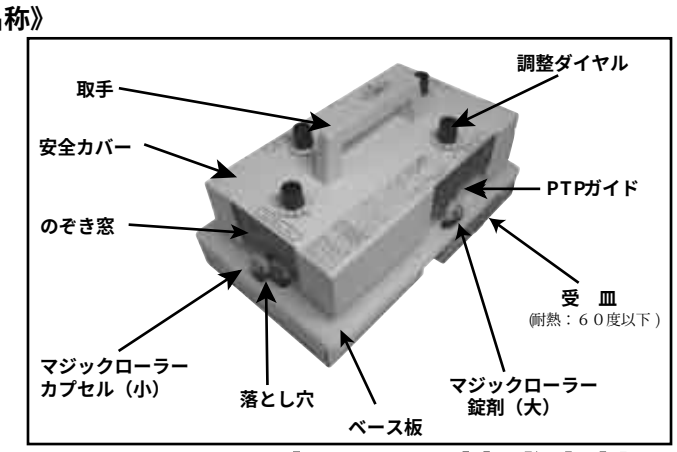

daido 大同化工株式会社

本　社／〒570-0016 大阪府守口市大日東町 34番 2号
TEL (06)6901-1855(代表)　FAX (06)6901-1910
お問い合わせ e-mail info@daido-kako.com

大同化工株式会社
簡剤便利グッズホームページ　http://www.daido-kako.com/

《オプション品（別売）》

ＰＴＰキャッチャー
（錠剤用・カプセル用）

※PTPシートが小形で持ちづらい場合などにご使用下さい。

錠剤用　　カプセル用

ＰＴＰキャッチャーの使い方



①ＰＴＰシート右端に錠剤・カプセルをセットして

★かたくてシートをセットしにくい場合は
この部分を指で右側に少し開きながらスライド
させてください。

②ＰＴＰシートをしっかりつかんでスライドさせます。

③奥までしっかり差し込みます。

＜関連商品＞

患者様にも

《ハンディ除包器》

独自の特許機構により、柔らい錠剤・カプセルなど除包する際に、お薬の破損を軽減しております。

製品名　トリダス　TOP-001-G
定　価　1,280円(税抜)

《錠剤配分用ケース》

分包機など錠剤やカプセルを投入する際にケースや瓶に容易に移し換える便利品

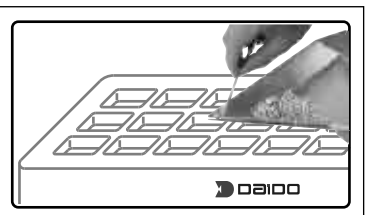

製品名　ステルスケース　HS-001
定　価　2,500円(税抜)

製品名　ステルスケースミニ　HS-002
定　価　1,980円(税抜)

《らく錠くん仕様》

機　種		タイプ４Ｒ	タイプ２
型　番		ＨＴ -2003	ＨＴ -3003
対応範囲		錠剤・ｶﾌﾟｾﾙ共用	錠剤専用
外寸	本体	W262× D183× H152(mm)	W205× D144× H146(mm)
	受皿	2本 W120× D120× H27(mm)	1本 W140× D140× H30(mm)
重　量		3 kg	1.8kg
材　質		ステンレス アルミ ＡＢＳ スチール アクリル ＰＶＣ	ステンレス アルミ ＰＰ スチール アクリル ＰＶＣ
機能方式		手動式	手動式
定　価		58,000円(税抜)	38,000円(税抜)
ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｰﾂ		PTPｷｬｯﾁｬｰ 錠剤用　2,500円(税抜) ｶﾌﾟｾﾙ用　2,500円(税抜)	PTPｷｬｯﾁｬｰ 錠剤用　2,500円(税抜)

《注意事項》

1、らく錠くんを使用する際には、左手で取手を押さえ右手でPTP　シートを持ってご使用下さい。
2、PTPシートは、本説明書の使用方法のとおりにお持ち下さい。それ以外の持ち方は思わぬケガや錠剤がでない原因となります。
3、**錠剤・カプセルの種類によっては、上手く取り出せない場合や破損する場合がございます。本製品はすべての錠剤・カプセルに対応できる訳ではございませんのでご了承ください。特に表面がやわらかい薬剤はマジックローラーの圧力を吸収して、下のアルミ箔が破れない場合があります。錠剤・カプセルが破損しますので、ご使用の際には特にご注意下さい。**
4、違う種類の薬剤を除包する際は、必ず受皿を取り出して前回の残りがないかをご確認下さい。また、PTPシートのアルミ箔がはがれ、薬剤に混入する場合がございますので、除包された薬剤は必ず確認し、アルミ箔が混入した場合は取り除いてください。

《製品保証書》

お客様名	
ご住所	(〒　　－　　)
電話番号	(　　)　　－
ご購入日	平成　　年　　月　　日
販売店名	
商品名	らく錠くん(タイプ２・タイプ４Ｒ)

保証事項)

1取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上げ日から1年間の保証期間内であれば、本体部分に限り無償修理致します。
2保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には、御施設名と電話番号をお申し出ください。尚、送付される場合には送料をご負担下さい。
3保証期間内でも次の場合には有償となります。
①本保証書を同封頂けなかったとき。又は、所定事項に未記入があったとき。
③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
④お買い上げ後の輸送、移動時の落下等、お取り扱いが不適当なために生じた故障及び損傷。
⑤説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって発生した故障及び損傷。
⑥改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷。
⑦消耗部・消耗品類の交換
4本製品故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては当社はその責に任じません。
5保証は日本国内においてのみ有効です。

《使用方法》

① 落とし穴を決める

錠剤・カプセルの大きさで、4つある落とし穴から下記を目安に
PTP除包する穴をきめます。

錠剤（大）	‥丸型のもので直径約10mm～14mm
錠剤（小）	‥丸型のもので直径約9mmまでのもの
カプセル（大）	‥‥00号、 0号、 1号、 2号 (らく錠くんタイプ４Rのみ)
カプセル（小）	‥‥3号、 4号 (らく錠くんタイプ４Rのみ)

※PTPシートの形状によって、上記と異なる場合がございます。
※長形の錠剤については、カプセルの穴をご使用下さい。

② 調整ダイヤルを合わせる 重要

調整ダイヤルで、錠剤・カプセルの厚みに合わせてマジックローラーの
高さをかえ、PTPを押し出す力の強さを調整します。

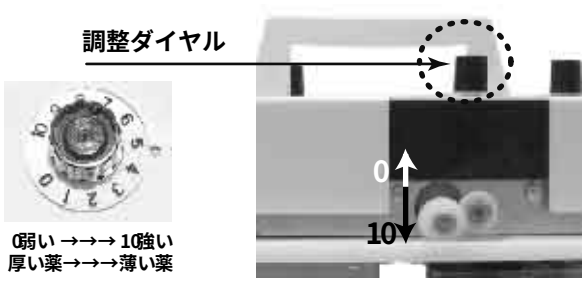

①調整ダイヤルを０に合わせます。マジックローラーが開放状態
になります。
②ＰＴＰ包装の錠剤（又はカプセル）をセットします。
③セットした錠剤（又はカプセル）の厚みに合うようにダイヤルの数値を
上げていき調整します。０→１→２・・・

種類	錠剤の厚み カプセルの硬さ	錠剤の高さ ＰＴＰの厚さ	ダイヤル参考値	機　　種
錠剤	厚い場合	高い	ダイヤル弱（3～4）	らく錠くん　全機種
	薄い場合	低い	ダイヤル強（7～）	
カプセル	硬い場合	厚い（硬）	ダイヤル弱（3～4）	らく錠くん　タイプ４R
	軟らかい場合	薄い（軟）	ダイヤル強（7～）	

【ご注意】上記の表は本体にも貼り付けております。上記、例は　タイプ４Ｒです。

③ ＰＴＰシートの握り方

※PTPシートはつまむのではなく、親指全体でしっかり握ってください。

④ 持ち方

1．ＰＴＰシートを引く方法（通常/右利き）



らく錠くんは左手で取手を押
さえ、右手でPTPシートを持
って引く方法でご使用下さい。

2．ＰＴＰシートを押す方法（左利き）



らく錠くんは右手で取手を押
さえ、左手でPTPシートを持
って押す方法でご使用下さい。

１と２の違いについて：１手早く除包できます。
２はＰＴＰシートを真っ直ぐ押せます。

⑤ ＰＴＰシートの引き方

PTPガイドにPTPの端を押し当てます。

拡大図

普通に引くと右側に曲がりやすいので、 PTPを**PTPガイドに押しつけるように意識しながら手前にすばやく平行に引いてください。**

⑤ ＰＴＰシートの引き方

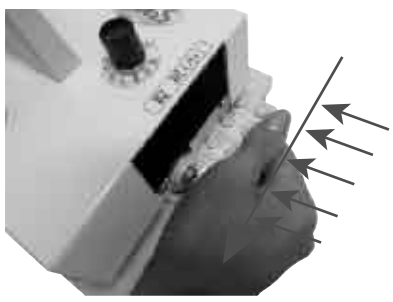





PTPが落とし穴に
ひっかかり錠剤・カプセルが
破損することがあります。

【ご注意】 除包する際の速さは、薬の形状にもよりますが、
目安としては錠剤 2秒・カプセルは４秒程度です。

⑥ 受皿のご使用方法

備え付けの受皿は、分包機のマスや瓶に移し替えしやすく傾斜をつけております。他のケースや容器にお薬を移し替える手間を軽減できます。

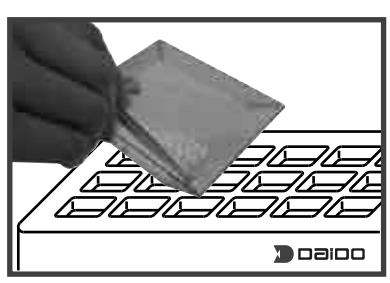

対象機種：タイプ２
ＨＴ -3003

対象機種：タイプ４Ｒ
ＨＴ -2003

⑦ ４列のPTPシートの除包の仕方

錠剤は最大４列まで除包できます。
２列目を除包する時は・・・
１列目と２列目の間をPTPガイドの下に差し込んでください。
３列目の時は１８０°回転させてください。

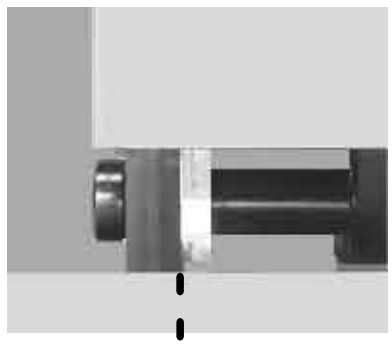

１８０°回転



<除包できない場合は>

Ａ．シートをこころもち下に曲げるように握ると、取り出しやすくなります。

Ｂ．錠剤・カプセルのＰＴＰシートによっては曲がっているものもあり、ＰＴＰガイドに正確に入らない場合があります。手でまっすぐに直してから除包してください。